DENTAL STUDIO S.O.S KIT

KIT Component

EASY REMOVER
Guide Tap을 Fixture에 체결하여 Implant를 제거할 때 사용합니다.
(권장 RPM 800~1200)

Implant Remover
Ratchet에 체결한 후 **'시계반대 방향'**으로 돌려서 사용합니다.

*본 제품은 일회용입니다.

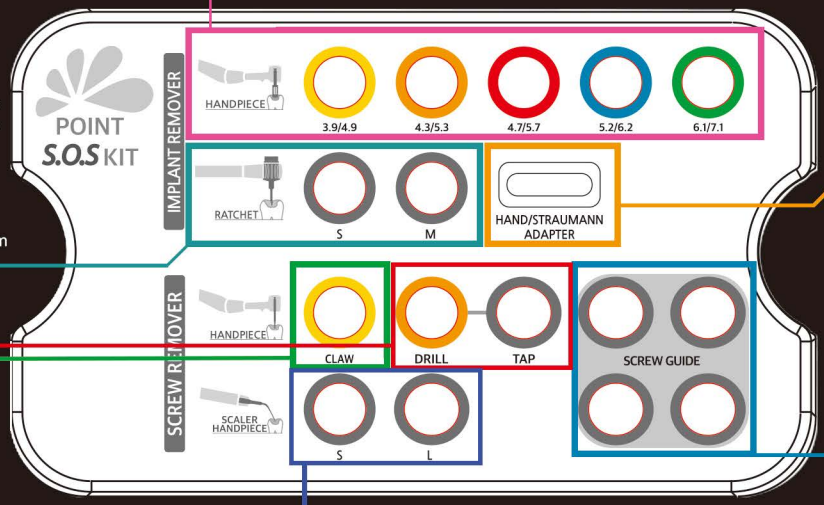

Hand/Strauman Adapter

Ratchet용 Driver를 Hand용으로 전환시킬 때 사용하거나 Strauman Rachet Wrench 사용시 연결용으로 사용합니다.

Screw Guide
Implant에 고정시키며, Implant내부 나사선 보호를 목적으로 합니다.

Claw Driver
부러진 Abutment Screw의 파절된 면에 고정하여 **시계 반대 방향**으로 돌려서 사용합니다.
권장 RPM 30~50

Scaler Handpiece
임플란트 내부의 파절된 Screw를 제거할 때 사용합니다.

Screw Drill
Claw Driver로도 파절된 스크류가 제거되지 않을 시, Screw Guide를 장착한 Screw Drill를 통해 **시계 방향**으로 드릴링합니다.
권장 RPM 1500~2000

Tap Driver
파절된 Abutment Screw에 드릴링 후 **시계 반대 방향**으로 돌려서 사용합니다.
권장 RPM 30~50

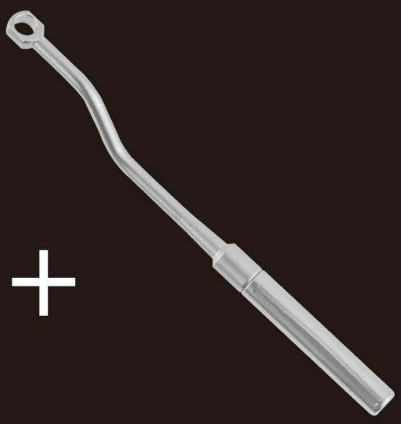

Guide Wrench (별도 구매 가능)
Screw Guide를 임플란트에 고정시킬 때 사용합니다.

***주의사항 -** 반드시 **회전방향**을 확인하시고 시술하여 주시길 바랍니다.

EASY REMOVER 제품 사양

	SIZE	INNER-OUTTER(mm)	IMPLANT REMOVING SIZE
	Ø3.5	3.9 - 4.9	Available in sizes less than 3.9mm
	Ø4.0	4.3 - 5.3	Available in sizes less than 4.3mm
	Ø4.5	4.7 - 5.7	Available in sizes less than 4.7mm
	Ø5.0	5.2 - 6.2	Available in sizes less than 5.2mm
	Ø6.0	6.1 -7.1	Available in sizes less than 6.1mm

Screw Remover Guide 호환 목록

Screw Guide	Implant System	Corporation
Active RP	NobelActive Ø4.3 , Ø5.0	Nobel Biocare
	InterActive Ø4.3 , Ø5.0	Implant Direct
External 2.7 HEX	Branemark System MK III Groovy (RP Ø3.75 , Ø4.0)	Nobel Biocare
	NobelSpeedy System MK III Groovy (RP Ø3.75 , Ø4.0)	
	3i External Hex Ø3.75 , Ø4.0	3i Biomet
	Restore Ø3.75 , Ø4.0	Keystone Dental
	US Implant Ø3.75 , Ø4.0	Osstem
8°Morse Taper	ITI Standard (Platform 4.8 , 6.5)	Straumann
	3i TG Osseotite	3i Biomet
	Stage -1 (Platform 4.8 , 6.5)	Keystone Dental
	SS Implant (Platform 4.8 , 6.0)	OSSTEM (HIOSSEN)
	SimpleLine (Platform 4.8 , 6.5)	Dentium
Submerged 2.5HEX	ASTRA TECH Ø4.5 , Ø5.0	DENTSPLY
	TS Impalt Ø4.0 , Ø4.5 , Ø5.0 (ET System)	OSSTEM (HIOSSEN)
	SuperLine & Implantium (All Implant)	Dentium
TSV 3.7/4.1	Taper Screw Vent Ø3.7 , Ø4.1	Zimmer
	Lagacy Ø3.7 , Ø4.2	OSSTEM (HIOSSEN)
	Internal Hex Ø3.7 , Ø4.1	BlueSkyBio
Camlog Tube-in-Tube	CAMLOG ROOT Line (Ø3.8 , Ø4.3)	CAMLOG

DENTAL STUDIO

IMPLANT REMOVER

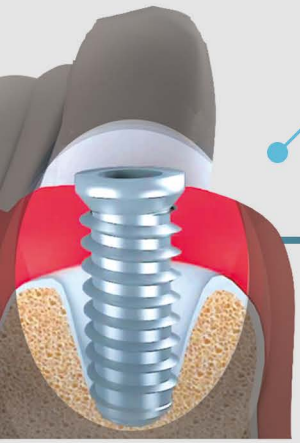

Implant Remover

Hand/Latch driver adapter
치과에서 보유한
토크라쳇과 호환 활용 가능

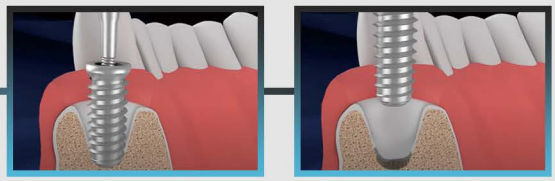

리무버를 임플란트와 체결한 후, 드라이브 어댑터나 토크라쳇과 연결하여
시계 반대방향으로 돌려 리무버 합니다.

임상 CASE

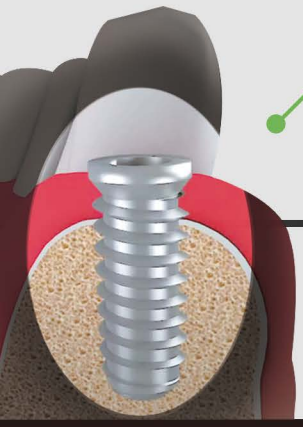

EASY REMOVER

권장 RPM 800~1200RPM

Implant Remover

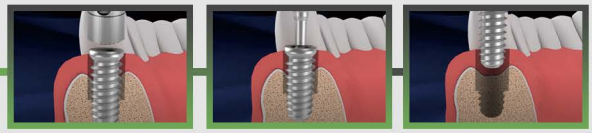

Easy Remover로 주변골을
드릴링한 후,
Implant Remover Screw를
이용하여 리무버 합니다.

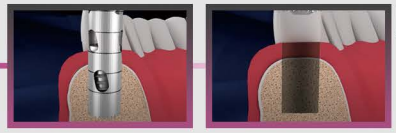

Easy Remover를 이용하여
임플란트를 제거 합니다.

임상 CASE

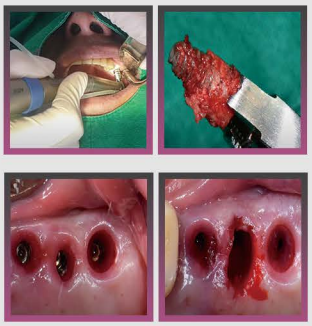

SCREW REMOVER

임플란트내부의 Screw가 파절된 상태

Screw Drill을 이용하여 충분한
주수하에 파절된 Screw에 **시계방향**으로
드릴링하여 Hole을 형성합니다.
권장 PRM - 1500~2000



Remover 실패시





Claw Driver를 임플란트 엔진에 체결하여
Screw Guide안에 넣고,
시계 반대방향으로 돌려 제거합니다.



권장RPM - 30~50

파절된 Screw에 Tap Driver를 사용하여
시계 반대방향으로 회전시켜 제거합니다.
권장RPM - 30~50

Fixture Connection정보를 확인 후, 그에 맞는
Screw Guide를 Guide Wrench에 체결 합니다.



술자의 숙련도에 따라 가이드 없이 claw driver 하나로
임플란트 내부의 screw를 제거할 수 있습니다.

임상 CASE